


Instruction Manual 1

Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor M2 (HEM-7143-E)

Read Instruction manual 1 and 2 before use.

For symbols information, refer to "Symbols Description" on the back side of the another "Instruction manual 1".

All for Healthcare

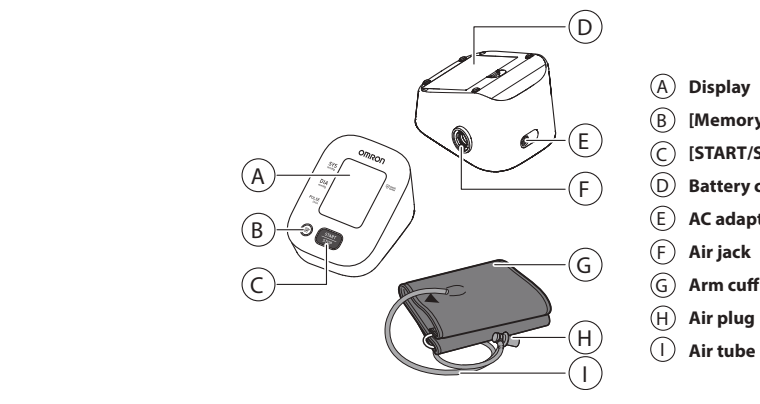

Introduction Thank you for purchasing the M2 Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor. This blood pressure monitor uses the oscillometric method of blood pressure measurement. This means this monitor detects your blood movement through your brachial artery and converts the movement into a digital reading.

Safety Instructions This instruction manual provides you with important information about the M2 Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor. To ensure the safe and proper use of this monitor, READ and UNDERSTAND all of these instructions. If you do not understand these instructions or have any questions, contact your OMRON retail outlet or distributor before attempting to use this monitor. For specific information about your own blood pressure, consult with your physician.

Intended Use This device is a digital monitor intended for use in measuring blood pressure and pulse rate in adult human population. This monitor detects the appearance of irregular heartbeats during measurement and indicates this via a symbol with readings. It is mainly designed for general household use.

Receiving and Inspection Remove this monitor from the packaging and inspect for damage. If this monitor is damaged, DO NOT use and consult with your OMRON retail outlet or distributor.

Important Safety Information Read the Important Safety Information in this instruction manual before using this monitor. Follow this instruction manual thoroughly for your safe use. For future reference, keep this instruction manual in a safe place. For specific information about your own blood pressure, consult with your physician.

Warning Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

DO NOT use this monitor on infants, toddlers, children or persons who are unable to understand instructions. DO NOT adjust medication based on readings from this blood pressure monitor. Take medication as prescribed by your physician. ONLY use a physician or qualified medical professional to treat high blood pressure.

DO NOT use this monitor on an injured arm or an arm under medical treatment. DO NOT apply the arm cuff on your arm while on an electric shock or other electrical device. DO NOT use this monitor in areas containing high frequency radio waves, such as in areas containing MRI equipment, computerized tomography (CT) scanners. This monitor is not intended for use in areas containing high frequency radio waves, such as in areas containing MRI equipment, computerized tomography (CT) scanners. This monitor is not intended for use in areas containing high frequency radio waves, such as in areas containing MRI equipment, computerized tomography (CT) scanners.

DO NOT use this monitor in oxygen rich environments or near oxygen tanks. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion. DO NOT use this monitor in an area where there is a risk of fire or explosion.

OMRON

IMI-HEM7143-E-02-04-2022 5674676-08

Replacing all 4 batteries with new ones is recommended. Refer to section 3 of instruction manual 2.

Batteries are low. Replacing all 4 batteries with new ones is recommended. Refer to section 3 of instruction manual 2.

Batteries are depleted. Immediately replace all 4 batteries with new ones. Refer to section 3 of instruction manual 2.

Batteries are not properly aligned. Check the battery placement for proper insertion. Refer to section 3 of instruction manual 2.

Blood pressure varies constantly. Many factors including stress, time of day, and/or how you apply the arm cuff, may affect your blood pressure. Review section 2 of instruction manual 2.

Press the [START/STOP] button to turn the monitor off, then press it again to take a measurement. If the problem continues, remove all batteries and wait for 30 seconds. Then re-insert batteries. Do not use the monitor until you receive a normal reading.

Check the battery placement for proper insertion. Refer to section 3 of instruction manual 2.

Change or modifications not approved by the manufacturer will void the warranty.

DO NOT tamper with it. DO NOT pinch it. DO NOT use it if it is gathered in a bundle. DO NOT place it under heavy objects. DO NOT use it with the AC adapter.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

Display/Problem Possible Cause Solution

The monitor has malfunctioned. Press the [START/STOP] button again. If "Er" still appears, contact your OMRON retail outlet or distributor.

Batteries are low. Replacing all 4 batteries with new ones is recommended. Refer to section 3 of instruction manual 2.

Batteries are depleted. Immediately replace all 4 batteries with new ones. Refer to section 3 of instruction manual 2.

Batteries are not properly aligned. Check the battery placement for proper insertion. Refer to section 3 of instruction manual 2.

Blood pressure varies constantly. Many factors including stress, time of day, and/or how you apply the arm cuff, may affect your blood pressure. Review section 2 of instruction manual 2.

Press the [START/STOP] button to turn the monitor off, then press it again to take a measurement. If the problem continues, remove all batteries and wait for 30 seconds. Then re-insert batteries. Do not use the monitor until you receive a normal reading.

Check the battery placement for proper insertion. Refer to section 3 of instruction manual 2.

Change or modifications not approved by the manufacturer will void the warranty.

DO NOT tamper with it. DO NOT pinch it. DO NOT use it if it is gathered in a bundle. DO NOT place it under heavy objects. DO NOT use it with the AC adapter.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

DO NOT use it with the AC adapter before cleaning this monitor.

4. Limited Warranty

Thank you for buying an OMRON product. This product is constructed of high quality materials and great care has been taken in its manufacturing. It is designed to give you every satisfaction, provided that it is properly operated and maintained as described in the instruction manuals and materials of this product. This product is warranted by OMRON for a period of 3 years after the date of purchase. The proper construction, workmanship and materials of this product is warranted by OMRON. During this period of warranty OMRON will, without charge for labour or parts, repair or replace the defect producing the cause of failure. The warranty does not cover any of the following: A. Transport costs and risks of shipping. B. Costs for repairs and/or defects resulting from repairs done by unauthorised persons. C. Accidental damage or misuse. D. Failure of optional parts or other attachments other than the main device itself, unless explicitly warranted above. E. Costs arising due to non-observance of a claim (including the charge for any kind including personal caused accidentally or from misuse. F. Calibration service is not included within the warranty. G. Optional parts have a one year warranty when purchased separately. Optional parts include, but are not limited to the following items: cuff and cuff tube. H. The product was purchased from or an authorised OMRON distributor. For the address refer to the product packaging / literature or to your specialised retailer. If you have difficulties in finding OMRON retail outlet or distributor, contact us for information: www.omron-healthcare.com

Repair or replacement under the warranty does not give rise to an extension or renewal of the warranty period. The product will be repaired or replaced with the original version / cash ticket issued to the customer by the retailer.

Should warranty service be required please apply to the dealer whom the product was purchased from or an authorised OMRON distributor. For the address refer to the product packaging / literature or to your specialised retailer. If you have difficulties in finding OMRON retail outlet or distributor, contact us for information: www.omron-healthcare.com

5. Guidance and Manufacturer's Declaration

This blood pressure monitor is designed according to the European Standard EN1060. Non-invasive sphygmomanometers Part 1: General requirements and an Annex Supplementing requirements for electromagnetic compatibility measuring systems. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.omron-healthcare.com

OMRON products are produced under the strict quality system of OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. Japan. Core component for OMRON blood pressure monitors, which is the Pressure Sensor, is produced in Japan.

OMRON is pleased to announce that the product has been certified by the Member State in which you are established about any serious incident that has occurred in relation to this device.

Important information regarding Electromagnetic Compatibility (EMC)

HEM-7143-E manufactured by OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. conforms to EN60601-1:2015 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard.

Further documentation in accordance with this EMC standard is available at: www.omron-healthcare.com

Correct disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that this product is not to be disposed of as general household waste at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact their retailer where they purchased this product, or their local authority, for details of where and how they can return this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées chez l'utilisateur ou le patient, ou endommager l'appareil ou tout autre équipement.

Arrêter d'utiliser ce tensiomètre et consulter votre médecin en cas d'irritation cutanée ou de gêne.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.


Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Mode d'emploi 1

Tensiomètre automatique brassard M2 (HEM-7143-E)

Lire le mode d'emploi 1 et 2 avant l'utilisation.

Pour plus d'informations sur les symboles, se reporter à la section « Description des symboles » au dos de l'autre « Mode d'emploi 1 ».

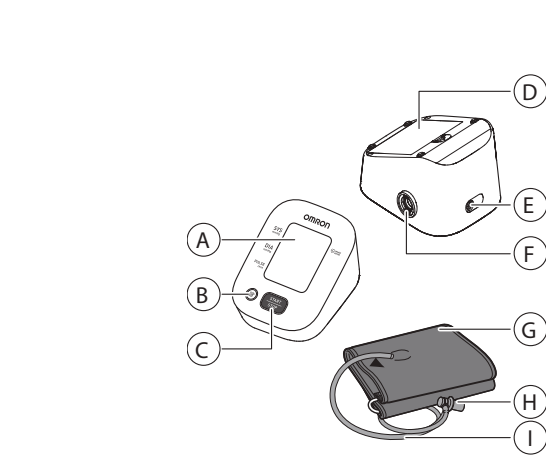

Introduction Merci d'avoir fait l'acquisition du tensiomètre automatique brassard M2. Ce tensiomètre mesure automatiquement la pression artérielle et le pouls chez l'adulte. Ce tensiomètre détecte les palpitations cardiaques inconscientes pendant la mesure et l'indique par le biais d'un symbole accompagnant les résultats. Il a été conçu essentiellement pour une utilisation générale à domicile.

Consignes de sécurité Ce mode d'emploi vous fournit des informations importantes sur le tensiomètre automatique brassard M2. Pour une utilisation sûre et correcte de ce tensiomètre, LIRE et COMPRÉHENDRE ces instructions. Si vous ne comprenez pas ces instructions ou avez des questions, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON avant d'essayer d'utiliser ce tensiomètre. Pour des informations spécifiques sur votre propre pression artérielle, consultez votre médecin.

Utilisation préventive Ce tensiomètre numérique est conçu pour mesurer la pression artérielle et le pouls chez l'adulte. Ce tensiomètre détecte les palpitations cardiaques inconscientes pendant la mesure et l'indique par le biais d'un symbole accompagnant les résultats. Il a été conçu essentiellement pour une utilisation générale à domicile.

Réception et inspection Retirez ce tensiomètre de son emballage et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. S'il est endommagé, NE PAS L'UTILISER et consulter votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Informations importantes sur la sécurité Ce mode d'emploi a été conçu pour être lu par des personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé. Le conservateur sur sa s'efforcer d'utiliser le tensiomètre. Pour des informations spécifiques sur votre propre pression artérielle, consultez votre médecin.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées chez l'utilisateur ou le patient, ou endommager l'appareil ou tout autre équipement.

Arrêter d'utiliser ce tensiomètre et consulter votre médecin en cas d'irritation cutanée ou de gêne.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Ne pas utiliser ce tensiomètre sur un bras mu ou sur un bras mu d'une perfusion intravasculaire ou sous traitement intravasculaire, ou pour une anastomose artériovénouse.

Affichage/Problème Cause possible Solution

Vous bougez ou parlez pendant la mesure. Restez immobile et ne pas parler pendant la mesure.

Le pouls n'est pas détecté correctement. Poser le brassard correctement, puis effectuer une nouvelle mesure. Se reporter à la section 4 du mode d'emploi 2.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a mal fonctionné. Appuyer à nouveau sur le bouton [START/STOP]. Si le symbole « Er » continue à s'afficher, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Le tensiomètre a

Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor

جهاز مراقبة ضغط الدم في أعلى الذراع الألي

M2 (HEM-7143-E)

ام2 (HEM-7143-E)



Intellisense

All for Healthcare

Read Instruction manual ① and ② before use.

FR Lire le mode d'emploi ① et ② avant l'utilisation.

DE Lesen Sie vor der Verwendung Gebrauchsanweisung ① und ②.

Italiano Leggere il manuale di istruzioni ① e ② prima dell'uso.

Español Lea el manual de instrucciones ① y ② antes del uso.

Nederlands Lees gebruiksaanwijzing ① en ② voor gebruik.

Русский Перед использованием прочтите руководства по эксплуатации ① и ②.

Türkçe Kullanmadan önce kullanım kılavuzu ① ve ②'yi okuyun.

العربية اقرأ دليل الإرشادات ① و ② قبل الاستخدام.

IM2-HEM-7143-E-01-10/2020

5674678-6A

1 Package Contents

FR Contenu de l'emballage

NL Inhoud van de verpakking

DE Packungsinhalt


RU Комплект поставки

IT Contenuto della confezione

TR Paketin İçindekiler

ES Contenido del envase

AR محتويات العبوة

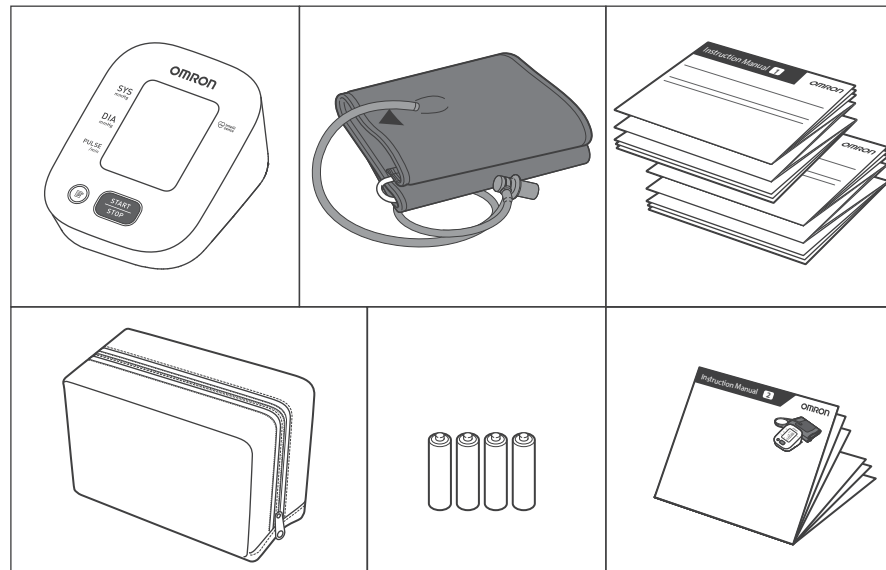

2 Preparing for a Measurement

FR Préparation d'une mesure

NL Een meting voorbereiden

DE Vorbereiten einer Messung

RU Подготовка к измерению

IT Preparazione per la misurazione

TR Ölçüm Hazırlığı

ES Preparación para una medición

AR التجهيز لعملية القياس

30 minutes before

FR 30 minutes avant

DE 30 Minuten vorher

IT 30 minuti prima

ES 30 minutos antes

NL 30 minuten ervoor

RU За 30 минут до

TR 30 dakika önce



AR قبل القياس بمدة تبلغ ٣٠ دقيقة

5 minutes before: Relax and rest.

FR 5 minutes avant : détente et repos.

DE 5 Minuten vorher: ruhig hinsetzen.

IT 5 minuti prima: rilassarsi e stare a riposo.

ES 5 minutos antes: relajarse y descansar.

NL 5 minuten ervoor: ontspan en rust.

RU За 5 минут до: расслабьтесь и отдохните.

TR 5 dakika önce: Gevşeyin ve dinlenin.

AR قبل القياس بمدة تبلغ ٥ دقائق: استرخ واسترخ.



3 Installing Batteries

FR Mise en place des piles

NL Batterijen plaatsen

DE Einsetzen der Batterien


RU Установка элементов питания (приобретаются дополнительно)

IT Installazione delle batterie

TR Pillerin Takılması

ES Instalación de las pilas

AR تركيب البطاريات

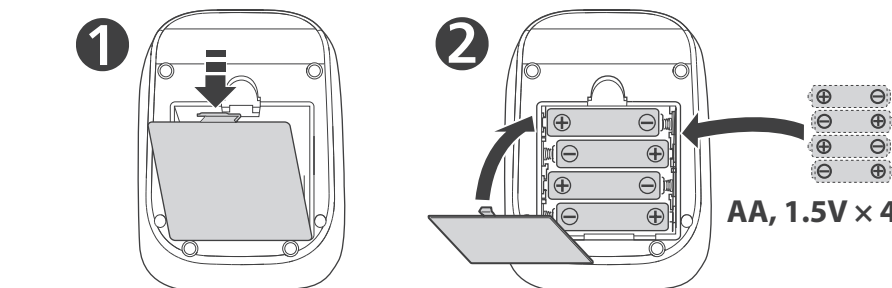

4 Applying the Cuff on the Left Arm

FR Pose du brassard sur le bras gauche

NL De manchet op de linkerarm aanbrengen

DE Anbringen der Manschette am linken Arm


RU Расположение манжеты на левой руке

IT Applicazione del bracciale sul braccio sinistro

TR Kolluğun Sol Kola Takılması

ES Colocación del manguito en el brazo izquierdo

AR لف الشريط الضاغط على الذراع الأيمن

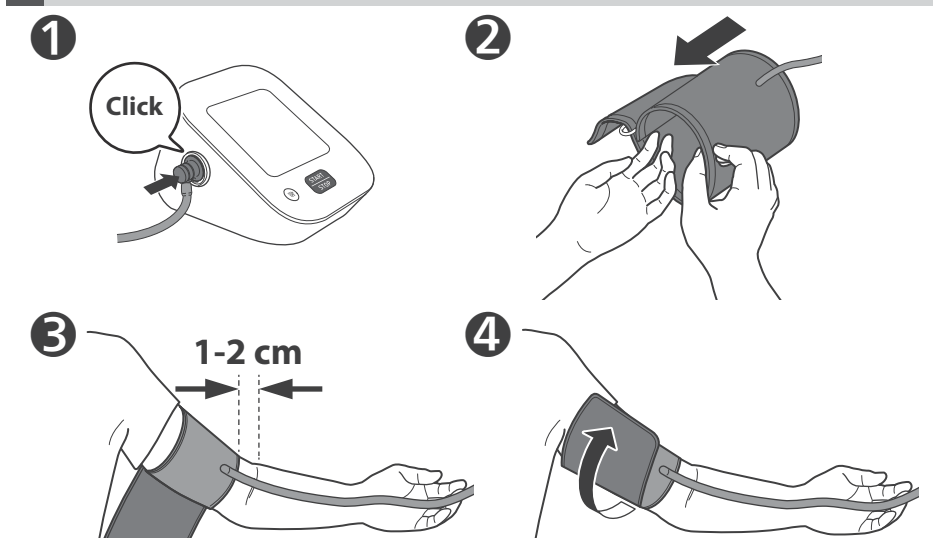

3 Tube side of the cuff should be 1 - 2 cm above the inside elbow.

FR Le côté tuyau du brassard doit être positionné 1 à 2 cm au-dessus de l'intérieur du coude.

DE Das Manschettenstück mit dem Schlauch muss 1 bis 2 cm oberhalb des Ellbogens liegen.

IT Il lato del bracciale con il tubo deve trovarsi al di sopra del gomito interno, a una distanza di circa 1 o 2 cm.

ES El lado del tubo del manguito deberá quedar 1 o 2 cm por encima de la parte interna del codo.

NL De kant met de slang van de manchet moet 1 - 2 cm boven de binnenkant van de elleboog liggen.

RU Край манжеты с трубкой должен находиться на 1–2 см выше локтевого сгиба.

TR Kolluğun boru tarafı, dirsek içinin 1 ila 2 cm üstünde olmalıdır.

AR يجب أن يرتفع جانب الخرطوم من الشريط الضاغط من ١ إلى ٢ سم عن المرفق.

4 Make sure that air tube is on the inside of your arm and wrap the cuff securely so it can no longer slip round.

FR Assurez-vous que le tuyau à air se trouve du côté intérieur de votre bras et enroulez fermement le brassard de manière qu'il ne puisse plus tourner.

DE Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch an der Arminnenseite sitzt, und befestigen Sie die Manschette sicher, so dass sie nicht verrutscht.

IT Assicurarsi che il tubo dell'aria si trovi all'interno del braccio e avvolgere il bracciale saldamente in modo che non possa ruotare.

ES Asegúrese de que el tubo de aire se encuentra en la cara interna del brazo y enrolle el manguito con firmeza para que no pueda deslizarse.

NL Zorg ervoor dat de luchtslang zich aan de binnenkant van uw arm bevindt en wikkel de manchet stevig rond uw arm zodat deze niet meer kan wegglijden.

RU Убедитесь, что воздуховодная трубка находится на внутренней поверхности плеча и надежно оберните манжету, чтобы она не прокручивалась вокруг руки.

TR Hava borusunun kolunuzun iç tarafında olduğundan emin olun ve kolluğu kaymayacak şekilde sabit şekilde sarın.

AR تأكد من أن خرطوم الهواء على الجانب الداخلي من ذراعك ولف الشريط الضاغط بإحكام بحيث لا ينزلق حول الذراع.

If taking measurements on the right arm, refer to:

FR Pour la prise de mesures au bras droit, voir :

DE Bei Messungen am rechten Arm siehe:

IT Se la misurazione viene eseguita al braccio destro, fare riferimento a:


ES Si va a realizar mediciones en el brazo derecho, consulte: Instruction Manual ①

NL Als u metingen aan de rechterarm uitvoert, raadpleeg dan: General Precautions

RU При измерении на правой руке см.

TR Sağ koldan ölçüm yapıyorsanız aşağıdakilere bakın:

AR في حال إجراء القياس على الذراع الأيمن، ارجع إلى:



5 Sitting Correctly

FR Position assise correcte

NL Correct zitten

DE Korrekte Körperhaltung


RU Правильная поза при измерении

IT Come sedere nel modo corretto

TR Düzgün Oturma

ES Cómo sentarse correctamente

AR الجلوس بشكل صحيح

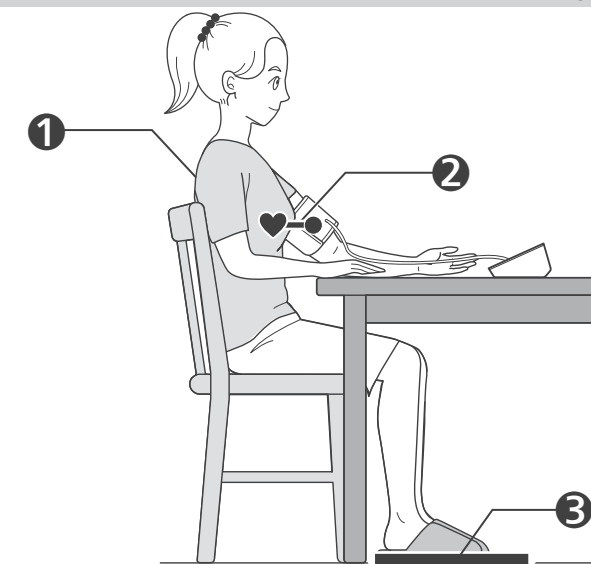

1 Sit comfortably with your back and arm supported.

FR S'asseoir confortablement de manière à ce que le dos et le bras soient bien soutenus.

DE Bequem hinsetzen, mit dem Rücken anlehnen und den Arm auf eine Unterlage legen.

IT Sedere comodamente con la schiena e il braccio ben sostenuti.

ES Siéntese cómodamente de modo que la espalda y el brazo estén bien apoyados.

NL Neem een comfortabele zitpositie in, met uw rug en arm ondersteund.

RU Сядьте удобно, чтобы спина и рука опирались на что-либо.

TR Sirtınız ve kolunuz desteklenerek rahat bir şekilde oturun.

AR اجلس بشكل مريح بحيث يكون الظهر والذراع في وضع مستند.

2 Place the arm cuff at the same level as your heart.

FR Le brassard doit se trouver au même niveau que votre cœur.

DE Die Manschette auf Herzhöhe platzieren.

IT Posizionare il bracciale allo stesso livello del cuore.

ES Coloque el manguito al mismo nivel que el corazón.

NL Plaats de armmanchet op hetzelfde niveau als uw hart.

RU Манжета должна находиться на уровне сердца.

TR Kolluğu kalbinizle aynı düzeye getirin.

AR ضع الشريط الضاغط للذراع في مستوى القلب نفسه.

3 Keep feet flat, legs uncrossed, remain still and do not talk.

FR Garder les pieds à plat, les jambes non croisées, ne pas bouger et ne pas parler.

DE Füße flach auf den Boden stellen, die Beine nicht kreuzen, still halten und nicht sprechen.

IT Tenere i piedi ben poggiati, non incrociare le gambe, rimanere fermi e non parlare.

ES Mantenga los pies planos, las piernas sin cruzar, quédese quieto y no hable.

NL Houd de voeten plat, benen niet gekruist, zit stil en praat niet.

RU Поставьте ноги ровно, не перекрещивая их, не двигайтесь и не разговаривайте.

TR Ayaklarınızı düz, bacaklarınızı açık tutun, hareketsiz kalın ve konuşmayın.

AR اجعل قدميك في وضع مسطح وساقيك في وضع متباعد وحافظ على ثباتك ولا تتحدث.

6 Taking a Measurement

FR Réalisation d'une mesure

NL Een meting doen

DE Vornehmen einer Messung


RU Выполнение измерений

IT Misurazione

TR Ölçüm Yapma

ES Obtención de una lectura

AR إجراء القياس

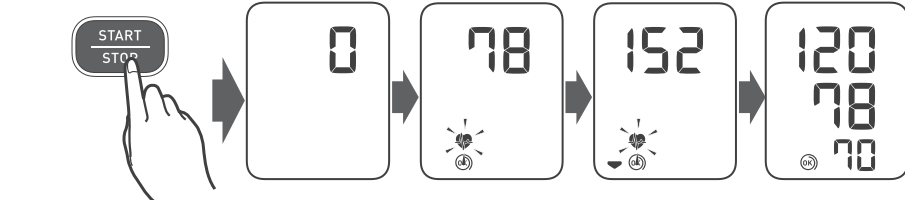

When the [START/STOP] button is pressed, the measurement is taken and saved automatically.

FR Après une pression sur le bouton [START/STOP], la mesure démarre et le résultat est enregistré automatiquement.

DE Beim Drücken der Taste [START/STOP] erfolgt die Messung. Die Messwerte werden automatisch gespeichert.

IT Quando si preme il pulsante [START/STOP], la misurazione viene eseguita e salvata automaticamente.

ES Al pulsar el botón [START/STOP], se obtiene la medición, que se guarda automáticamente.

NL Wanneer op de knop [START/STOP] wordt gedrukt, wordt de meting automatisch uitgevoerd en opgeslagen.

RU После того, как кнопка [START/STOP] нажата, измерение выполняется и сохраняется автоматически.

TR [START/STOP] düğmesine basıldığında ölçüm yapılır ve otomatik olarak kaydedilir.

AR عند الضغط على زر [START/STOP]، يتم إجراء القياس وحفظه تلقائيًا.

If your systolic pressure is more than 210 mmHg:

After the arm cuff starts to inflate, press and hold the [START/STOP] button until the monitor inflates 30 to 40 mmHg higher than your expected systolic pressure.

FR Si votre pression systolique est supérieure à 210 mmHg :

Lorsque le brassard se gonfle, appuyez sur le bouton [START/STOP] et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le tensiomètre atteigne une pression de gonflage supérieure de 30 à 40 mmHg à votre pression systolique attendue.

DE Wenn Ihr systolischer Druck höher ist als 210 mmHg: Nachdem die Manschette begonnen hat, sich aufzupumpen, drücken Sie die [START/STOP]-Taste, und halten Sie sie gedrückt, bis ein Druck von 30 bis 40 mmHg über Ihrem erwarteten systolischen Druck erreicht ist.

IT Se la pressione sistolica è superiore a 210 mmHg: Quando il bracciale inizia a gonfiarsi, premere e mantenere premuto il pulsante [START/STOP] finché il misuratore non raggiunge una pressione da 30 a 40 mmHg superiore rispetto al valore di pressione sistolica atteso.

ES En caso de que su presión arterial sistólica esté por encima de 210 mmHg: Una vez que el manguito comienza a inflarse, mantenga pulsado el botón [START/STOP] hasta que el monitor indique que el inflado está entre 30 y 40 mmHg por encima de la presión arterial sistólica esperada.

NL Als uw systolische druk hoger is dan 210 mmHg: Zodra de armmanchet wordt opgepompt, houdt u de knop [START/STOP] ingedrukt totdat de meter 30 tot 40 mmHg hoger aangeeft dan uw verwachte systolische druk.

RU Если систолическое давление выше 210 мм.рт.ст.: После того, как началось автоматическое нагнетание воздуха в манжету, нажмите и удерживайте кнопку [START/STOP] до тех пор, пока электронный блок не поднимет давление до значения, превышающего ожидаемое систолическое давление на 30–40 мм рт. ст.

TR Sistolik basıncınız 210 mmHg'den fazlaysa: Kolluk şişmeye başladıktan sonra, [START/STOP] düğmesine basın ve ölçüm cihazı beklediğiniz sistolik basınç değerinden 30 ila 40 mmHg daha fazla şişene kadar basılı tutun.

AR إذا كان ضغط دمك الانقباضي أكثر من ٢١٠ ملليمترات زئبقية:

بعد بدء انتفاخ الشريط الضاغط للذراع، اضغط مع الاستمرار على الزر [START/STOP] حتى يقوم الجهاز بالنفخ من ٣٠ إلى ٤٠ ملليمترًا زئبقيًا أعلى من قيمة ضغط الدم الانقباضي المتوقعة لديك.


AR إذا كان ضغط دمك الانقباضي أكثر من ٢١٠ ملليمترات زئبقية:

بعد بدء انتفاخ الشريط الضاغط للذراع، اضغط مع الاستمرار على الزر [START/STOP] حتى يقوم الجهاز بالنفخ من ٣٠ إلى ٤٠ ملليمترًا زئبقيًا أعلى من قيمة ضغط الدم الانقباضي المتوقعة لديك.

7 Checking Readings

FR Vérification des résultats
DE Prüfen der Messwerte
IT Controllo dei risultati
ES Comprobación de lecturas

NL Metingen bekijken
RU Проверка результатов
TR Ölçüm Değerlerini Kontrol Etme
AR التحقق من القراءات

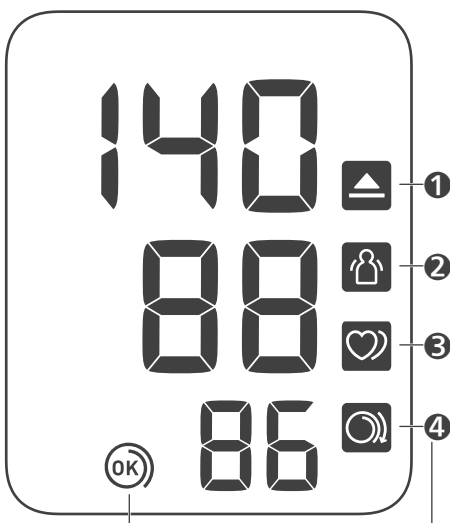

1 Appears if "SYS" is 135 mmHg or above and/or "DIA" is 85 mmHg* or above.

FR S'affiche si « SYS » est égale ou supérieure à 135 mmHg et/ou « DIA » égale ou supérieure à 85 mmHg*.
DE Wird angezeigt, wenn „SYS“ 135 mmHg oder mehr beträgt und/oder wenn „DIA“ 85 mmHg* oder mehr beträgt.

IT Viene visualizzato se la pressione sistolica "SYS" è pari o superiore a 135 mmHg e/o la pressione diastolica "DIA" è pari o superiore a 85 mmHg*.
ES Aparece si "SYS" es 135 mmHg o superior y/o "DIA" es 85 mmHg* o superior.

NL Verschijnt als "SYS" 135 mmHg of hoger is en/of "DIA" 85 mmHg* of hoger is.
RU Отображается, если «SYS» (Систолическое давление) 135 мм рт.ст. и выше и/или «DIA» (Диастолическое давление) 85 мм рт.ст.* и выше.

TR "SYS" 135 mmHg ya da üstünde olduğunda ve/veya "DIA" 85 mmHg* ya da üstünde olduğunda görünür.
AR تظهر إذا كان "SYS" يبلغ ١٣٥ ملليمترًا زئبقيًا أو أكثر و/أو "DIA" ٨٥ ملليمترًا زئبقيًا* أو أكثر.

2 Appears when your body moves during a measurement. Remove the arm cuff, wait 2 - 3 minutes and try again.

FR S'affiche si vous bougez pendant une mesure. Retirer le brassard, attendre 2 à 3 minutes et essayer à nouveau.
DE Wird angezeigt, wenn Sie sich während der Messung bewegen. Nehmen Sie die Manschette ab, warten Sie 2–3 Minuten und versuchen Sie es erneut.

IT Viene visualizzato se l'utilizzatore si muove durante la misurazione. Rimuovere il bracciale, attendere 2-3 minuti e riprovare.
ES Aparece cuando se mueve el cuerpo durante una medición. Retire el manguito, espere unos 2 o 3 minutos e inténtelo de nuevo.

NL Verschijnt wanneer uw lichaam tijdens een meting beweegt. Verwijder de armanchet, wacht 2-3 minuten en probeer het opnieuw.
RU Отображается при движении тела во время измерения. Снимите манжету, подождите 2-3 минуты и попробуйте еще раз.

TR Bir ölçüm esnasında vücudunuz hareket ettiğinde görünür. Kolluğu çıkarın, 2 - 3 dakika bekleyip tekrar deneyin.
AR تظهر عند تحرك جسمك في أثناء عملية القياس. قم بإزالة الشريط الضاغط للذراع وانتظر من ٢ إلى ٣ دقائق وحاول مرة أخرى.

3 Appears when an irregular rhythm** is detected during a measurement. If it appears repeatedly, OMRON recommends to consult your physician.

FR S'affiche lorsqu'un rythme irrégulier** est détecté pendant une mesure. S'il s'affiche à plusieurs reprises, OMRON recommande de consulter votre médecin.
DE Wird angezeigt, wenn während einer Messung ein unregelmäßiger Herzschlag** festgestellt wird. Wird das Symbol wiederholt angezeigt, empfiehlt OMRON, sich an Ihren Arzt zu wenden.

IT Viene visualizzato se nel corso di una misurazione viene rilevato un ritmo cardiaco irregolare**.
Se il simbolo appare ripetutamente, OMRON consiglia di consultare il medico curante.
ES Aparece cuando se detecta un ritmo irregular** durante una medición. Si aparece varias veces, OMRON recomienda que consulte a su médico.

NL Verschijnt wanneer tijdens een meting een onregelmatig ritme** wordt gedetecteerd. Als dit herhaaldelijk verschijnt, raadt OMRON aan om uw arts te raadplegen.
RU Отображается, если при измерении определяется нерегулярный ритм**. Если этот символ отображается неоднократно, компания OMRON рекомендует обратиться к лечащему врачу.

TR Bir ölçüm esnasında düzensiz ritim** saptandığında görünür. Tekrarlı şekilde görünürse OMRON doktorunuza danışmanızı önerir.
AR تظهر عند اكتشاف عدم انتظام ضربات القلب** في أثناء عملية القياس. عند ظهورها بشكل متكرر، توصي OMRON باستشارة طبيبكم.

FR Le brassard est suffisamment serré.
DE Manschette sitzt ausreichend straff.
IT Il bracciale è stretto a sufficienza.
ES El manguito está lo suficientemente prieto.
NL Manchet zit strak genoeg.
RU Манжета затянута достаточно туго.
TR Kolluk yeterince sıkıdır.
AR الشريط الضاغط محكم بما يكفي.

FR Poser le brassard en le serrant davantage.
DE Manschette STRAFFER ziehen.
IT Applicare di nuovo il bracciale STRINGENDOLO DI PIÙ.
ES Vuelva a poner el manguito MÁS PRIETO.
NL Breng de manchet STRAKKER aan.
RU Наложите манжету еще раз БОЛЕЕ ТУГО.
TR Kolluğu tekrar, DAHA SIKI bir şekilde takın.
AR لف الشريط الضاغط مرة أخرى بشكل أكثر إحكامًا.

FR La définition de l'hypertension est basée sur les recommandations ESH/ESC 2018.
DE Die Definition für Bluthochdruck basiert auf den 2018 ESH/ESC Richtlinien.
IT La definizione di alta pressione arteriosa si basa sulle linee guida 2018 di ESH/ESC.
ES La definición de presión arterial alta se basa en las guías 2018 ESH/ESC.
NL De definitie van hoge bloeddruk is gebaseerd op de ESH/ESC-richtlijnen uit 2018.
RU *Определение высокого артериального давления основано на Рекомендациях 2018 ESH/ESC.
TR *Yüksek kan basıncı tanımı, 2018 ESH/ESC Kilavuzlarını temel alır.

FR *تعريف ضغط الدم المرتفع يستند إلى إرشادات الجمعية الأوروبية لفرط ضغط الدم (ESH)/الجمعية الأوروبية لطب القلب (ESC) لعام 2018.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *The high blood pressure definition is based on the 2018 ESH/ESC Guidelines.
DE *Die Definition für Bluthochdruck basiert auf den 2018 ESH/ESC Richtlinien.
IT *La definizione di alta pressione arteriosa si basa sulle linee guida 2018 di ESH/ESC.
ES *La definición de presión arterial alta se basa en las guías 2018 ESH/ESC.
NL *De definitie van hoge bloeddruk is gebaseerd op de ESH/ESC-richtlijnen uit 2018.
RU *Определение высокого артериального давления основано на Рекомендациях 2018 ESH/ESC.
TR *Yüksek kan basıncı tanımı, 2018 ESH/ESC Kilavuzlarını temel alır.
AR *تعريف ضغط الدم المرتفع يستند إلى إرشادات الجمعية الأوروبية لفرط ضغط الدم (ESH)/الجمعية الأوروبية لطب القلب (ESC) لعام 2018.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *The high blood pressure definition is based on the 2018 ESH/ESC Guidelines.
DE *Die Definition für Bluthochdruck basiert auf den 2018 ESH/ESC Richtlinien.
IT *La definizione di alta pressione arteriosa si basa sulle linee guida 2018 di ESH/ESC.
ES *La definición de presión arterial alta se basa en las guías 2018 ESH/ESC.
NL *De definitie van hoge bloeddruk is gebaseerd op de ESH/ESC-richtlijnen uit 2018.
RU *Определение высокого артериального давления основано на Рекомендациях 2018 ESH/ESC.
TR *Yüksek kan basıncı tanımı, 2018 ESH/ESC Kilavuzlarını temel alır.
AR *تعريف ضغط الدم المرتفع يستند إلى إرشادات الجمعية الأوروبية لفرط ضغط الدم (ESH)/الجمعية الأوروبية لطب القلب (ESC) لعام 2018.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

8 Using Memory Functions

FR Utilisation des fonctions de mémoire
DE Verwendung der Speicherfunktionen
IT Uso delle funzioni di memoria
ES Uso de las funciones de memoria
NL Geheugenfuncties gebruiken
RU Использование функции памяти
TR Hafıza Fonksiyonunun Kullanılması
AR استخدام وظائف الذاكرة

FR Messages d'erreur ou autres problèmes ? Voir :
DE Weitere Fehlermeldungen oder Probleme siehe:
IT Messaggi di errore o altri problemi? Fare riferimento a:
ES ¿Hay mensajes de error u otros problemas? Consulte:
NL Foutmeldingen of andere problemen? Raadpleeg:
RU Сообщения об ошибках или другие неисправности? См.
TR Hata mesajları veya başka sorunlar mı var? Bkz:
AR رسائل الخطأ أو المشكلات الأخرى؟ ارجع إلى:

FR Réinitialisation aux réglages par défaut
DE Wiederherstellen der Standardeinstellungen
IT Ripristino delle impostazioni predefinite
ES Restablecimiento a los ajustes de fábrica
NL De standaardinstellingen herstellen
RU Восстановление настроек по умолчанию
TR Varsayılan Ayarları Geri Yükleme
AR استعادة الإعدادات الافتراضية

FR Mesures stockées en mémoire
DE Gespeicherte Messwerte
IT Risultati conservati in memoria
ES Lecturas guardadas en la memoria
NL Metingen opgeslagen in het geheugen
RU Сохранение результатов в памяти
TR Hafızaya Kaydedilen Değerler
AR تم تخزين القراءات في الذاكرة

FR Jusqu'à 30 mesures sont stockées.
DE Es werden bis zu 30 Messwerte gespeichert.
IT Vengono conservati fino a 30 risultati.
ES Se almacenan hasta 30 lecturas.
NL Er kunnen tot 30 meetwaarden worden opgeslagen.
RU Сохраняется до 30 результатов.
TR 30 adede kadar ölçüm değeri saklanır.
AR يصل عدد القراءات المخزنة إلى ٣٠ قراءة.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل ٢٥٪ أو أكثر منه بمعدل ٢٥٪.

FR *Un rythme cardiaque irrégulier est défini comme un rythme inférieur ou supérieur de 25 % au rythme moyen détecté durant une mesure.
DE *Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird.
IT **Si definisce ritmo cardiaco irregolare un ritmo cardiaco inferiore del 25% o superiore del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante una misurazione.
ES **Latido cardíaco irregular se define como un ritmo que es un 25 % menor o un 25 % mayor que el ritmo medio detectado durante una medición.
NL **Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat 25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde ritme dat tijdens een meting wordt gedetecteerd.
RU **Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25% медленнее или быстрее измеренного среднего ритма.
TR **Düzensiz kalp atışı ritmi, bir ölçüm sırasında saptanan ortalamadan %25 daha düşük veya %25 daha yüksek ritim olarak tanımlanır.
AR **تعريف اضطراب ضربات القلب بأنه نظم أقل من النظم الطبيعي الذي يتم اكتشافه في أثناء عملية القياس بمعدل